

RÓTULOS

YUWELL

HeartSave Y, HeartSave YA


PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matricula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

Yuwell Heart Save Y, Heart Save YA

Modelos : HeartSave Y0, HeartSave Y1, HeartSave Y2, HeartSave Y3, HeartSave Y5, HeartSave Y6, HeartSave Y7, HeartSave Y8, HeartSave YA0, HeartSave YA1, HeartSave YA2, HeartSave YA3, HeartSave YA5, HeartSave YA6, HeartSave YA7, HeartSave YA8.

Fabricado por: JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
No. 1 Baisheng Road Development Zone
Danyang, Jiangsu 212300
República Popular de China

Importado y Distribuido por: DRIPLAN S.A.
Catalina de Boyle 3340 (Calle 28)
Gral San Martín (B1650IMD)
Bs. As. Argentina

Fecha de Fabricación: _____ **Número de Serie:** _____

Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 °C **Temperatura de Operación:** 0 a 55 °C

Instrucciones de Uso
Leer el Manual de Instrucciones


⚠ Advertencias y Precauciones

Leer Manual de Instrucciones

Director Técnico: Bioing. Francisco Rivas MP: I-6762

Condición de venta: “Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias”

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM: 1608-108


PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matrícula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

YUWELL

HeartSave Y, HeartSave YA



**PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.**



**Bioing. Francisco Rivas
Matricula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.**

Yuwell Heart Save Y, Heart Save YA

Modelos : HeartSave Y0, HeartSave Y1, HeartSave Y2, HeartSave Y3, HeartSave Y5, HeartSave Y6, HeartSave Y7, HeartSave Y8, HeartSave YA0, HeartSave YA1, HeartSave YA2, HeartSave YA3, HeartSave YA5, HeartSave YA6, HeartSave YA7, HeartSave YA8.

Fabricado por: JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
No. 1 Baisheng Road Development Zone
Danyang, Jiangsu 212300
República Popular de China

Importado y Distribuido por: DRIPLAN S.A.
Catalina de Boyle 3340 (Calle 28)
Gral San Martín (B1650IMD)
Bs. As. Argentina

Fecha de Fabricación: _____ **Número de Serie:** _____

Temperatura de almacenamiento: 0 a 50 °C **Temperatura de Operación:** 0 a 55 °C

Instrucciones de Uso
Leer el Manual de Instrucciones

⚠ Advertencias y Precauciones

Leer Manual de Instrucciones

Director Técnico: Bioing. Francisco Rivas MP: I-6762

Condición de venta: “Venta exclusiva a profesionales e Instituciones Sanitarias”

AUTORIZADO POR LA A.N.M.A.T. PM: 1608-108


PABLO VAZQUEZ⁴
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matrícula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

YUWELL
HeartSave Y, HeartSave YA

Uso acorde a los fines establecidos

El Desfibrilador Externo Automático HeartSave Series Y y YA está diseñado para su uso en adultos y niños en caso de fibrilación ventricular.

Las series HeartSave Y | YA también guían al usuario durante la reanimación cardiopulmonar (RCP) mediante voz.

Si se detecta un ritmo desfibrilable en un paciente, el dispositivo administra una descarga al corazón para normalizar el ritmo.

El dispositivo de las series HeartSave Y | YA se mantiene en el paciente hasta que llega la asistencia profesional, incluso si el paciente comienza a respirar nuevamente.

El equipo está diseñado para el tratamiento de pacientes adultos y niños en combinación con los parches de electrodos OBS-DE/P(303A1204)/REF 97847. Los pacientes de 8 años o más y/o con un peso superior a 25 kg se tratan como adultos. Los pacientes de 1 a 8 años que pesan menos de 25 kg se tratan como niños.

Descripción de los detalles del equipo

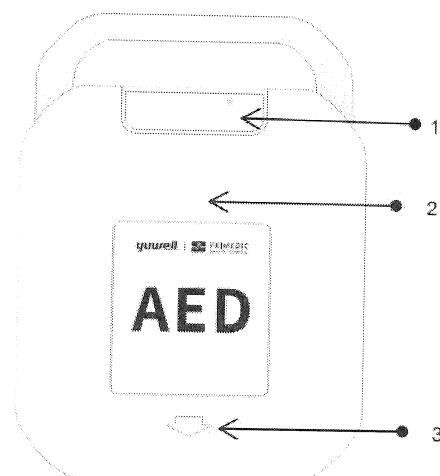
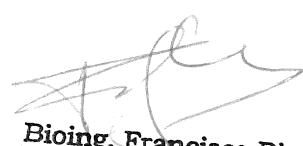


Fig. 1 Vista frontal con cubierta

- (1) Pantalla de estado
- (2) Cubierta del dispositivo
- (3) Abrir la cubierta como indica el ícono

CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
EN EL ESTADO DE GUATEMALA
EN LA FECHA DE 10 DE MARZO DE 2017

PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matricula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

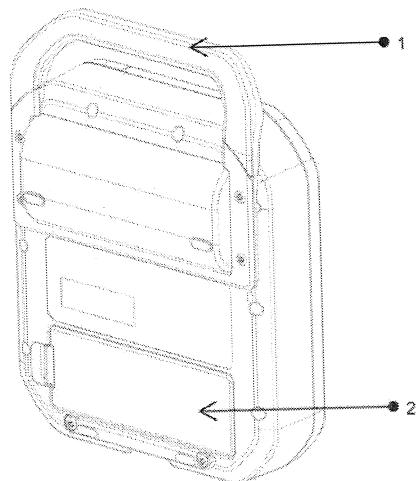


Fig. 2 Vista trasera

- (1) Asa de transporte
- (2) Batería

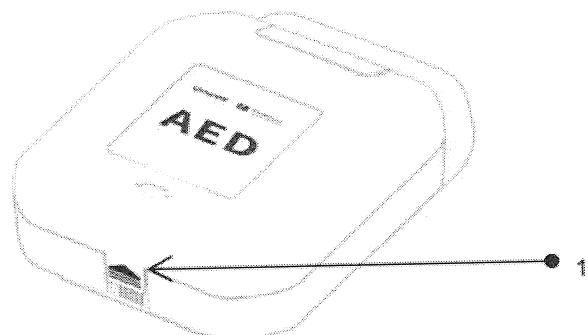


Fig. 3 Vista inferior

- (1) Bloqueo de apertura de la cubierta del dispositivo

PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.

Bioing. Francisco Rivas
Matricula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.


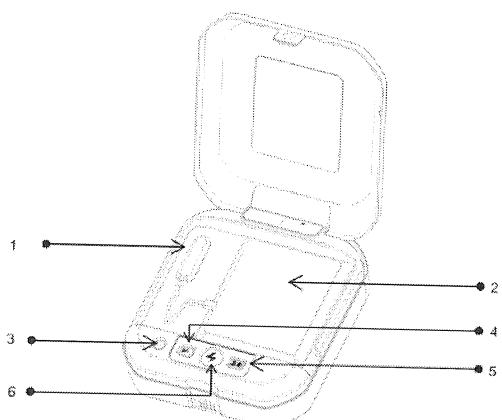


Fig. 4 Vista frontal de las series HeartSave Y | YA

- (1) Enchufe para conectores de electrodos y puerto USB
- (2) Parches de electrodos
- (3) Interruptor de encendido/apagado con retroiluminación verde
Luces verdes: el equipo está encendido y puede funcionar correctamente
- (4) Botón de cambio de idioma
- (5) Botón de modo pediátrico con retroiluminación
Luces verdes: modo pediátrico
No se enciende: modo para adultos
- (6) Botón de descarga con retroiluminación roja solo para la serie HeartSave Y (botón de liberación para desfibrilación)
Rojo parpadeante: listo para generar una descarga

Los electrodos del HeartSave Y | YA vienen preconectados de fábrica y no es necesario enchufarlos antes del primer uso. No obstante, si se han sustituido o desenchufado, deben volver a conectarse a la unidad de acuerdo con el siguiente procedimiento.

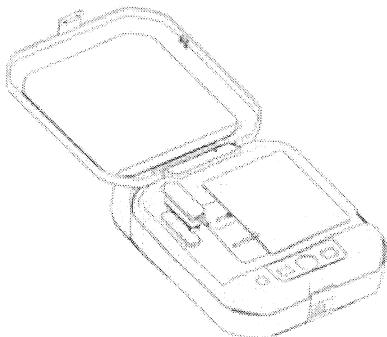

Procedimiento de instalación:

- Presione la tapa para abrir la cubierta del dispositivo
- Inserte el conector del electrodo en la interfaz del electrodo
- Coloque los parches de electrodos en el dispositivo


PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.

Bioing. Francisco Rivas
Matrícula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

Aplicación de los electrodos

Extracción de la película de los electrodos


- (1) Película protectora en los electrodos
- (2) Parches de electrodos de desfibrilación

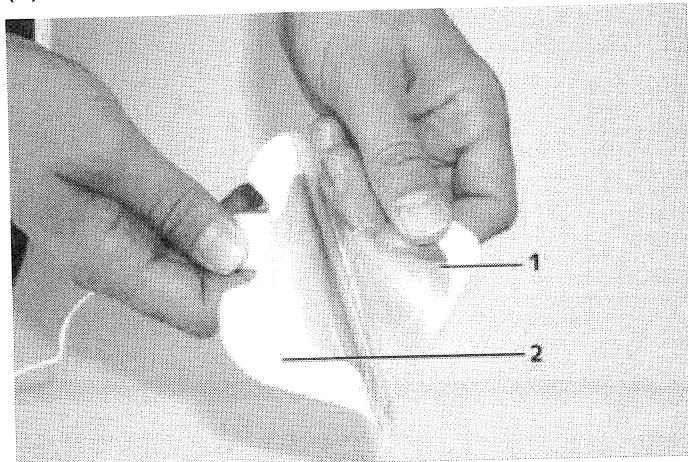

Posición de los electrodos en adultos

Las posiciones de los electrodos son:


- Rojo ①: en el lado derecho del pecho, debajo de la clavícula, y
- Verde ②: en el lado izquierdo del pecho, arriba del vértice del corazón en la línea axilar.

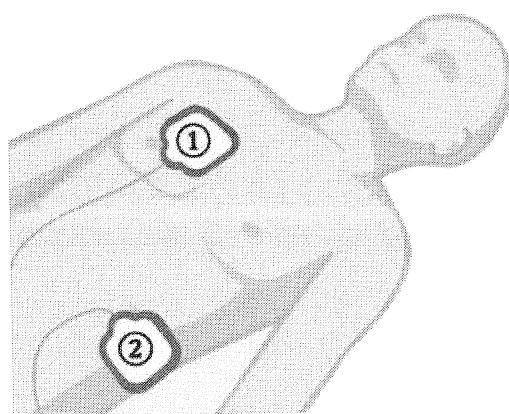

Posición de los electrodos en niños

Las posiciones de los electrodos son:


- Rojo ①: en la espalda, a la misma altura que el corazón
- Verde ②: en el centro del pecho


PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matrícula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

Para limpiar su equipo, siga estas reglas:


1. Apague el equipo, desconecte los cables y retire la batería.
2. Limpie la pantalla de estado con un paño limpio y suave humedecido con limpiacristales.
3. Limpie la superficie exterior del equipo con un paño suave y limpio humedecido con el producto de limpieza recomendado.
4. Quite toda la solución de limpieza con un paño seco después de limpiar si es necesario.
5. Seque su equipo en un lugar ventilado y fresco.



PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.



Bioing. Francisco Rivas
Matricula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.

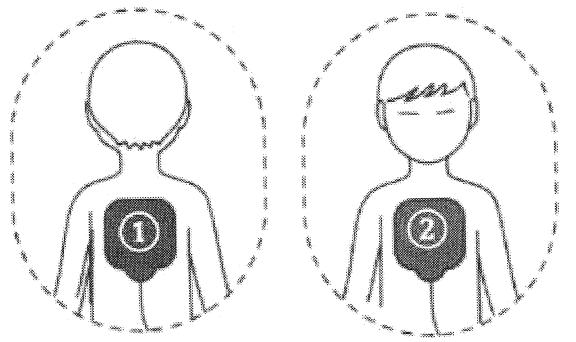

El HeartSave le indicará con un mensaje de voz que le coloque los electrodos de desfibrilación al paciente.

Pegar los electrodos como se muestra en la imagen

Retire toda la ropa del pecho del paciente, abra los electrodos y péquelos en el torso desnudo como se muestra en la imagen

Procedimiento:

- Abra el embalaje de los electrodos de desfibrilación.
- Retire la película protectora de uno de los electrodos y luego coloque inmediatamente el electrodo en la posición que había determinado anteriormente.
- Proceda a retirar la película protectora del segundo electrodo y colóquelo en su posición.
- Alise los electrodos sobre el paciente asegurándose de que no haya burbujas de aire debajo de los electrodos.

Limpieza

Los productos de limpieza recomendados son:

- Agua
- Etanol (75 %)
- Alcohol isopropílico (70 %)


PABLO VAZQUEZ
PRESIDENTE
DRIPLAN S.A.


Bioing. Francisco Rivas
Matrícula N° I-6.762
Co. Director Técnico
Driplan S.A.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: DRIPLAN SOCIEDAD ANONIMA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.