



## **INSTRUCCIONES DE USO**

(según Anexo III.B Disposición ANMAT N.º 2318/02 T.O. 2004).

### **ADVAMRYL**

**SUTURA QUIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORBIBLE SINTÉTICA POLIGLECAPRONA MONOFILAMENTO COLOR 25**

#### **DESCRIPCIÓN**

La sutura ADVAMRYL es una sutura quirúrgica estéril monofilamento absorbible sintética compuesta de un copolímero hecho de un copolímero de glicólido y  $\epsilon$ -caprolactona. La fórmula empírica del copolímero es  $([CH_2-CO-O]_x-[C_5H_{10}-CO-O]_y)_n$  - (donde,  $x : y = 7.5:2.5$ ).

Se ha descubierto que el copolímero de poliglecaprona 25 es no antigenico, no pirogenico y provoca sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. La sutura ADVAMRYL está disponible en violeta y sin teñir. La sutura está teñida con D y C violeta núm. 2 (Índice de color N.º 60725/Violeta solvente 13).

La sutura ADVAMRYL está disponible en diferentes tamaños.

La sutura ADVAMRYL cumple con la Farmacopea europea para "Suturas monofilamento absorbibles sintéticas estériles" y el requisito de la Farmacopea de los Estados Unidos para "Sutura quirúrgica absorbible" con un diámetro apenas mayor.

#### **INDICACIONES**

La sutura ADVAMRYL está indicada para uso en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en cirugía oftálmica, microcirugía, tejidos cardiovasculares y neurológicos.

#### **APLICACIONES**

La selección de la sutura dependerá del estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida.

#### **RENDIMIENTO**

La sutura ADVAMRYL se bioabsorbe y se biodegrada durante el período. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de la sutura ADVAMRYL se produce mediante hidrólisis. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa. Toda la resistencia a la tracción original se pierde 21 días después de la implantación. La absorción de la sutura ADVAMRYL es totalmente completa hasta 90 días.

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglecaprona 25.

Día de implantación	% aproximado de fuerza original restante	
	TENIDO	NO TENIDO
7 Día (1 to 5-0)	60 %	55 %
14 Día (1 to 3-0 & 5-0)	40 %	20 %
14 Día (4-0)	40 %	15 %

#### **CONTRAINDICACIONES**

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglecaprona 25.

#### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Los usuarios deben conocer el procedimiento quirúrgico en el que se utilizan suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el material de sutura utilizado.

Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolini  
Socio Gerente

**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TÉCNICO  
MARIO G. MITELMAN  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554



Los cirujanos deben considerar el rendimiento in vivo de la sutura que se ha detallado en la sección de rendimiento antes de la aplicación de la sutura. Esta sutura puede ser inapropiada en pacientes ancianos, desnutridos o debilitados, o en pacientes que padecen condiciones que pueden retrasar la cicatrización de heridas. Al igual que con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con soluciones salinas, como las que se encuentran en las vías urinarias o biliares, puede provocar la formación de cálculos. Se debe seguir una práctica quirúrgica aceptable para el tratamiento de heridas contaminadas o infectadas.

La sutura ADVAMRYL es un material de sutura quirúrgico absorbible; se debe considerar el uso de sutura no absorbible suplementaria siempre que se requiera refuerzo adicional, es decir, donde la sutura se usa en lugares que pueden expandirse o estirarse.

Las suturas cutáneas que deben permanecer en su lugar durante más de 7 días pueden causar irritación localizada y deben cortarse o retirarse según se indique. La sutura subcuticular debe colocarse lo más profundamente posible para minimizar el eritema y la induración, normalmente asociados con el proceso de absorción.

En algunas circunstancias, especialmente en procedimientos ortopédicos, la inmovilización de las articulaciones mediante un refuerzo externo puede emplearse a discreción de los cirujanos.

Se debe tener en cuenta el uso de sutura absorbible en tejido con riego sanguíneo deficiente, ya que puede producirse una extrusión de la sutura y una absorción demorada.

Los nudos de sutura ADVAMRYL deben colocarse correctamente para que sean seguros. La seguridad adecuada del nudo requiere las técnicas quirúrgicas aceptadas de ataduras cuadradas y planas con vueltas adicionales según lo justifiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Se debe tener cuidado al manipular la sutura quirúrgica, especialmente la aguja. No sostenga la aguja cerca de la parte de la punta, manténgala entre 1/3 y 1/2 parte del lado de unión de la aguja. Las agujas están especialmente acanaladas, según corresponda, para ayudar a sujetarlas con firmeza.

Agarrar el área de la punta podría afectar el rendimiento de la penetración y provocar que la aguja se quiebre. Tomar la parte trasera o el accesorio podría causar que se doble o se rompa. Las agujas estéticas pueden hacer que pierdan fuerza y sean menos resistentes a doblarse y romperse.

Los usuarios deben tener cuidado al manipular las agujas quirúrgicas para evitar pinchazos deseche las agujas usadas en un recipiente para objetos punzantes.

Deseche la sutura usada de acuerdo con las Reglas Locales de Manejo de Desechos Biomédicos.

Evite los daños por aplastamiento o rizado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos como pinzas o portaaguas.

No reutilice el producto, ya que puede provocar una infección y no lo vuelva a esterilizar, ya que puede provocar cambios en las propiedades de la sutura o afectar el rendimiento del producto.

## **REACCIONES ADVERSAS**

Los efectos adversos, que pueden estar asociados con el uso de este producto, incluyen: dehiscencia de la herida, falta de refuerzo adecuado a la herida en los lugares donde se produce la expansión, estiramiento o distensión, falta de apoyo adecuado a la herida en pacientes con afecciones que pueden retrasar la herida, cicatrización, irritación localizada cuando las suturas cutáneas se dejan colocadas durante más de 7 días, formación de cálculos cuando se produce un contacto prolongado con soluciones salinas, mayor infectividad bacteriana, reacción inflamatoria aguda mínima e irritación local transitoria.

## **ESTERILIDAD**

La sutura ADVACRYL se esteriliza con óxido de etileno. No utilice paquetes de suturas abiertos o dañados. El producto es sensible a la humedad, por lo tanto, incluso una pequeña abertura/orificio puede dañar la resistencia de la sutura de manera adversa. No doble parte del paquete de suturas ni use vendas elásticas para atar los paquetes de suturas. Deseche las suturas abiertas sin usar.

## **ALMACENAMIENTO**

La condición de almacenamiento recomendada es entre 2°C y 25°C. Mantener alejado de la humedad y el calor directo. No utilice el paquete de papel aluminio después de la fecha de expiración.

*Alcamed S.R.L.*  
Alberto Brandolini  
Socio Gerente

**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TÉCNICO  
MARIO G. MITELMAN  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

**ALCAMED SRL**

Achega 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)**ALCAMED S.R.L**  
INSUMOS MEDICOS**CONDICIÓN DE USO**

Uso exclusivo a profesionales e instituciones sanitarias

**VIDA ÚTIL**

5 años a partir de su fecha de fabricación.

**PRESENTACIÓN**

Se presentan en estuches o cajas de 12 unidades envasadas individualmente.

**FABRICANTE**

Advanced MedTech Solutions Private Limited - P-21-22, 25-26, 34-35, GIDC Manjusar, Tal Savli, Dist.- Vadodara - 391775 Gujarat, India.

**IMPORTADOR**

ALCAMED SRL, Pje. Achega 3076 – CABA, Argentina.

Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554

Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

**SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS RÓTULOS:**

No volver a esterilizar



No volver a utilizar



No usar en caso de que el envoltorio esté dañado

Precaución



Fabricante



Esterilizado con óxido de etileno



Utilizar antes de la fecha



Código de lote



Fecha de fabricación



Mantener alejado de la luz solar



Límite de temperatura



Mantener en lugar seco



Consultar las instrucciones de uso

**instrucciones de uso****ADVAMRYL**

Fabricado en India

Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.  
P-21-22,25-26 & 34-35, GIDC Manjusar,  
Tal - Savli, Dist - Vadodara - 391775.**IMPORTADOR**

ALCAMED SRL, Pje. Achega 3076 – CABA, Argentina.

Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554

Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

Número gratuito: 1800 419 0607

e-mail – [customerservice@amsli.com](mailto:customerservice@amsli.com)

AMR/FL/SP/01

Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandoftino  
Socio Gerente**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TÉCNICO  
MARIO G. MITELMAN  
FARMACEUTICO - M.P. 8554

**ALCAMED SRL**

Achega 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)**ALCAMED S.R.L**  
INSUMOS MÉDICOS**ADVAMRYL**

Sutura quirúrgica absorbible (sintética)

Poliglicoprona monofilamento

color 25 - Sin teñir y violeta

**Descripción:**

La sutura ADVAMRYL es una sutura quirúrgica estéril monofilamento absorbible sintético compuesta de un copolímero hecho de un copolímero de glicolida y  $\epsilon$ -caprolactona. La fórmula empírica del copolímero es  $(\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O})_x-(\text{CH}_2-\text{CO}-\text{O})_y$ , - (donde,  $x:y = 7:5.25$ )

Se ha descubierto que el copolímero de poliglicoprona 25 es no antigenico, no protígenico y provoca sólo una ligera reacción tisular durante la absorción. La sutura ADVAMRYL está disponible en violeta y sin teñir. La sutura está teñida con D & C violeta n.º 2 (índice de color N.º 60725/violeta solvente 13).

La sutura ADVAMRYL está disponible en diferentes tamaños [2 (5 métrico) - 6-0 (0.7 métrico)], longitud: con agujas sin ojos atraumáticas de acero inoxidable incorporadas o sin agujas.

La sutura ADVAMRYL cumple con la Farmacopea europea para "Suturas monofilamento absorbible sintéticas estériles" y el requisito de la Farmacopea de los Estados Unidos para "Sutura quirúrgica absorbible" con un diámetro aparente mayor.

**INDICACIONES:**

La sutura ADVAMRYL está indicada para uso en aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, pero no para uso en cirugía oftálmica, microcirugía, tejidos cardiovasculares y neurológicos.

**APLICACIONES:**

La selección de la sutura dependerá del estado del paciente, la experiencia quirúrgica, la técnica quirúrgica y el tamaño de la herida.

**RENDIMIENTO:**

La sutura ADVAMRYL se biabsorbe y se biodegrada durante el periodo. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de la sutura ADVAMRYL se produce mediante hidrólisis. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa.

Toda la resistencia a la tracción original se pierde 21 días después de la implantación. La absorción de la sutura ADVAMRYL es totalmente completa hasta 90 días.

Día de Implantación	% aproximado de fuerza original restante	TENIDO	NO TENIDO
7. Día (1 to 5-0)	60 %	55 %	
14. Día (1 to 5-0 & 5-0)	40 %	20 %	
14. Día (4-0)	40 %	15 %	

**INTRAINDICACIONES:**

No utilice sutura ADVAMRYL donde se requiera una aproximación prolongada de los tejidos sometidos a tensión. El uso de sutura está contraindicado en pacientes con sensibilidades o alergias conocidas a la Poliglicoprona 25.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Los usuarios deben conocer el procedimiento quirúrgico en el que se utilizan suturas absorbibles, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el material de sutura utilizado.

Los cirujanos deben considerar el rendimiento in vivo de la sutura que se ha detallado en la sección de rendimiento antes de la aplicación de la sutura.

Esta sutura puede ser inapropiada en pacientes ancianos, desnutridos o debilitados, o en pacientes que padecen condiciones que pueden retrasar la cicatrización de heridas.

Al igual que con cualquier cuerpo extraño, el contacto prolongado de cualquier sutura con soluciones salinas, como las que se encuentran en las vías urinarias o biliares, puede provocar la formación de cálculos. Se debe seguir una práctica quirúrgica aceptable para el tratamiento de heridas contaminadas o infectadas.

La sutura ADVAMRYL es un material de sutura quirúrgico absorbible; se debe considerar el uso de sutura no absorbible suplementaria siempre que se requiera refuerzo adicional; es decir, donde la sutura se usa en lugares que pueden expandirse o estirarse.

Las suturas cutáneas que deben permanecer en su lugar durante más de 7 días pueden causar irritación localizada y deben cortarse o retirarse según se indique. La sutura subcutánea debe colocarse lo más profundamente posible para minimizar el entumecimiento y la inducción, normalmente asociados con el proceso de absorción.

En algunas circunstancias, especialmente en procedimientos ortopédicos, la inmovilización de las articulaciones mediante un refuerzo externo puede emplearse a discreción de los cirujanos.

Se debe tener en cuenta el uso de sutura absorbible en tejido con riego sanguíneo deficientes, ya que puede producirse una extrusión de la sutura y una absorción demorada.

Los nudos de sutura ADVAMRYL deben colocarse correctamente para que sean seguros. La seguridad adecuada del nudo requiere las técnicas quirúrgicas aceptadas de ataduras cuadradas y planas con

vuelta(s) adicionales según lo justifiquen las circunstancias quirúrgicas y la experiencia del cirujano.

Se debe tener cuidado al manipular la sutura quirúrgica, especialmente la aguja. No sostenga la aguja cerca de la parte de la punta, manténgala entre 1/3 y 1/2 parte del lado de unión de la aguja. Las agujas están especialmente acomodadas, según corresponda, para ayudar a sujetarlas con firmeza.

Agarrar el área de la punta podría afectar el rendimiento de la penetración y provocar que la aguja se quiebre. Tomar la parte traseras o el accesorio podría causar que se doble o se rompa. Las agujas estériles pueden hacer que pierdan fuerza y sean menos resistentes a doblarse y romperse.

Los usuarios deben tener cuidado al manipular las agujas quirúrgicas para evitar pinchazos. Deseche las agujas usadas en un recipiente para objetos punzantes. Deseche la sutura usada de acuerdo con las Reglas Locales de Manejo de Desecho Biomédicos. Evite los daños por aplastamiento o rotado debido a la aplicación de instrumentos quirúrgicos como pinzar o portagujas.

No realice el producto, ya que puede provocar una infección y no lo vuelva a esterilizar, ya que puede provocar cambios en las propiedades de la sutura o afectar el rendimiento del producto.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Los efectos adversos, que pueden estar asociados con el uso de este producto, incluyen dehiscencia de la herida, falta de refuerzo adecuado a la herida en los lugares donde se produce la expansión, estiramiento o distensión, falta de apoyo adecuado a la herida en pacientes con afecciones que pueden retrasar la herida, cicatrización, irritación localizada cuando las suturas cutáneas se dejan colocadas durante más de 7 días, formación de cálculos cuando se produce un contacto prolongado con soluciones salinas, mayor infectividad bacteriana, reacción inflamatoria aguda mínima e irritación local transitoria.

**ESTERILIDAD:**

La sutura ADVACRYL se esteriliza con óxido de etileno. No utilice paquetes de suturas abiertos o dañados. El producto es sensible a la humedad; por lo tanto, incluso una pequeña abertura/rotura puede dañar la resistencia de la sutura de manera adversa. No doble parte del paquete de suturas ni use vendas elásticas para atar los paquetes de suturas. Deseche las suturas abiertas sin usar.

**ALMACENAMIENTO:**

La condición de almacenamiento recomendada es entre 2°C y 25°C. Mantener alejado de la humedad y el calor directo. No utilice el paquete de papel aluminio después de la fecha de expiración.

Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolino  
Socio Gerente

**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TÉCNICO  
MARIO G. MITELMAN  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554




**PROYECTO DE ROTULOS SEGÚN DISPOSICIÓN 2318/02 Y 2323/02 ANEXO III.B**

**ADVAMRYL**

**SUTURA QUIRÚRGICA ESTÉRIL ABSORBIBLE SINTÉTICA POLIGLECAPRONA MONOFILAMENTO 25**

**ROTULADO ENVASE PRIMARIO - SOBRE INDIVIDUAL**

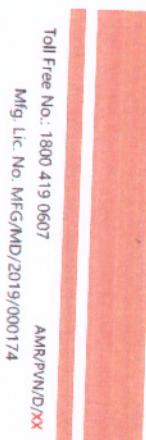


**ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)  
**ADVAMRYL****

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 VIOLET  
 STERILISED SURGICAL NEEDLED SUTURE

STERILE EO 25°C

**AMS**  
 Advanced MedTech Solutions

Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.  
 P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusar, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.  
 e-mail - [customercare@amsitd.com](mailto:customercare@amsitd.com)

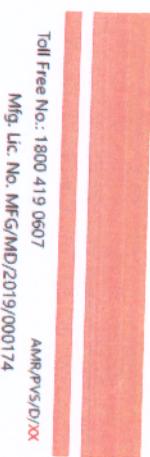


**ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)  
**ADVAMRYL****

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 VIOLET  
 STERILISED SURGICAL SUTURE

STERILE EO 25°C

**AMS**  
 Advanced MedTech Solutions

Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.  
 P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusar, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.  
 e-mail - [customercare@amsitd.com](mailto:customercare@amsitd.com)

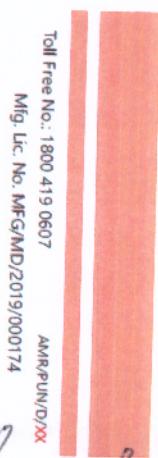

**ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)  
**ADVAMRYL****

MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 UNDYED  
 STERILISED SURGICAL NEEDLED SUTURE

STERILE EO 25°C

**AMS**  
 Advanced MedTech Solutions

Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.  
 P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusar, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.  
 e-mail - [customercare@amsitd.com](mailto:customercare@amsitd.com)

**ADVAXXXX  
 X-X(X metric)  
 XX cm**

VXXXXX  
 LOT

MM/YY  
 MFG.

MM/YY  
 EXP.

Needle  
 description  
 ▼

**ADVAXXXX  
 X-X(X metric)  
 XX cm**

VXXXXX  
 LOT

MM/YY  
 MFG.

MM/YY  
 EXP.

**ADVAXXXX  
 X-X(X metric)  
 XX cm**

VXXXXX  
 LOT

MM/YY  
 MFG.

MM/YY  
 EXP.

Needle  
 description  
 ▼

PEEL HERE

PEEL HERE

PEEL HERE

Alcamed S.R.L.  
 Alberto Brandolino  
 Socio Gerente

**ALCAMED S.R.L.**  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 MARIO G. MITELMAN  
 FARMACÉUTICO - M.P. 8554

**ALCAMED SRL**

Acheba 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)**ALCAMED S.R.L**  
INSUMOS MEDICOS

Toll Free No.: 1800 419 0607  
Mfg. Lic. No. MFG/M/2019/000174

AMR/PUS/DX

**ABSORBABLE SURGICAL SUTURE (SYNTHETIC)  
ADVAMRYL**MONOFILAMENT POLIGLECAPRONE 25 UNDYED  
STERILISED SURGICAL SUTURE

STERILE EO



Advanced MedTech Solutions

Advanced MedTech Solutions Pvt. Ltd.  
P-21-22, 25-26 & 34-35, GIDC Manjusar, Tal. Savli, Dist. Vadodara 391775, Gujarat, India.  
e-mail - [customerservice@amsmedtech.com](mailto:customerservice@amsmedtech.com)

**ADVAXXXX****X-X(X metric)****XX cm****XXXXXX****LOT****MM/YY****MFG.****MM/YY****EXP.**

PEEL HERE

Importado por:  
**ALCAMED S.R.L**  
Acheba 3076, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.  
**USO EXCLUSIVO A PROFESIONALES E INSTITUCIONES SANITARIAS**  
Dirección Técnica: Farm. Mario Mitelman. Mat. Nac. N°8.554  
Autorizado por la ANMAT PM-2403-28

Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolini  
Socio Gerente


**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TECNICO  
MARIO G. MATELMAN  
FARMACEUTICO - M.P. 8554





**ALCAMED SRL**  
Achega 3076 – CABA, Argentina.  
Tel.: +54 11 45715616  
[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)  
[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)  
[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)



**ALCAMED S.R.L**  
INSUMOS MEDICOS

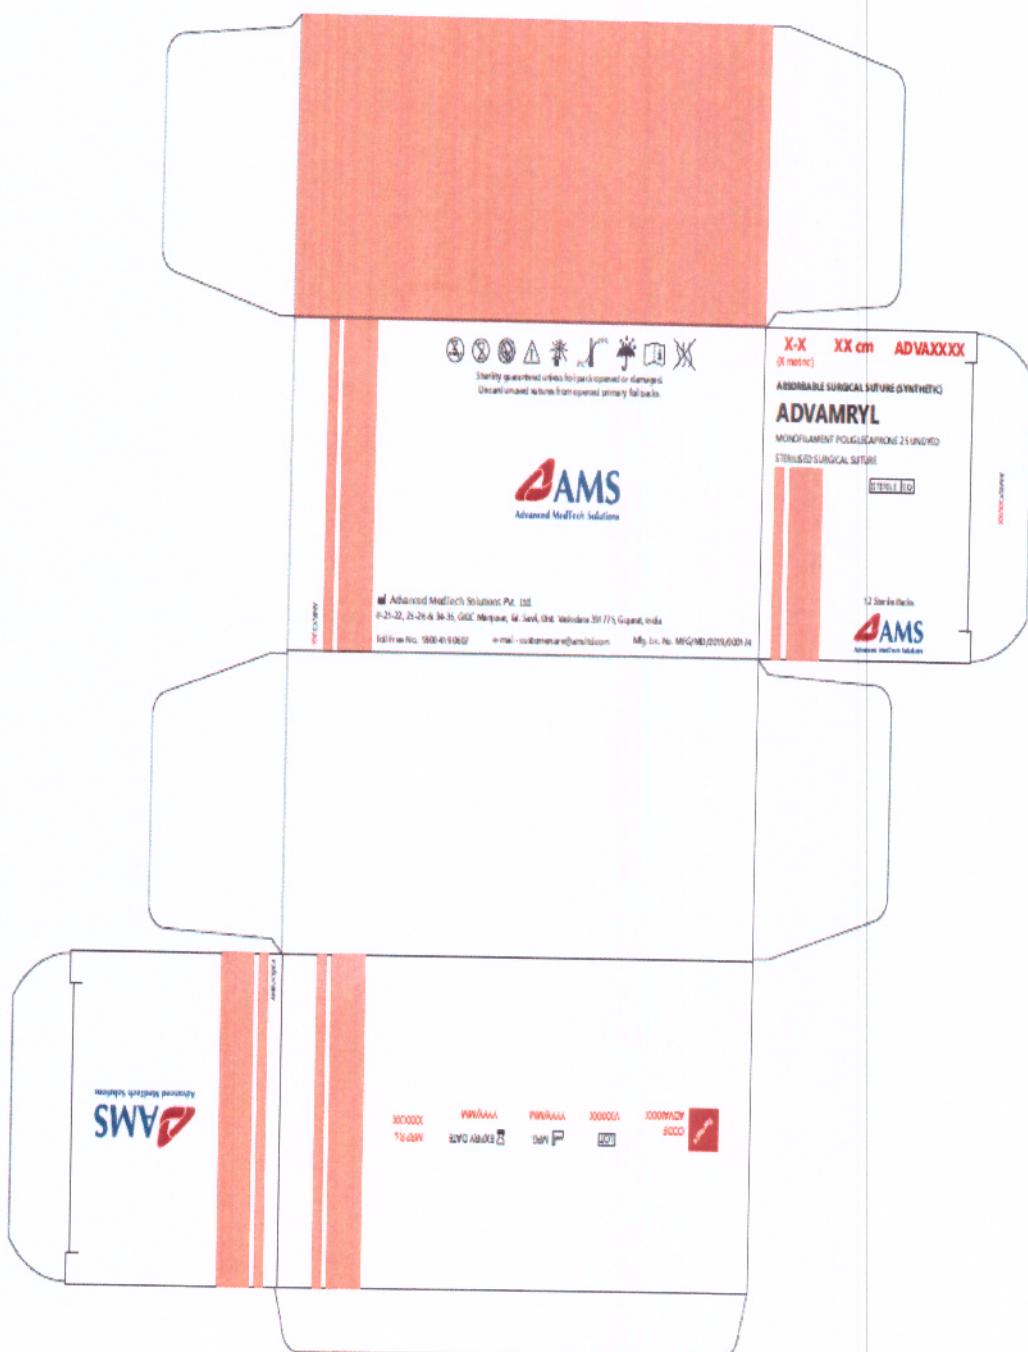


  
Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolini  
Socio Gerente

  
**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TECNICO  
**MARIO G. MAMELMAN**  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

**ALCAMED SRL**  
Achega 3076 – CABA, Argentina.  
Tel.: +54 11 45715616  
[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)  
[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)  
[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)



**ALCAMED S.R.L**  
INSUMOS MEDICOS

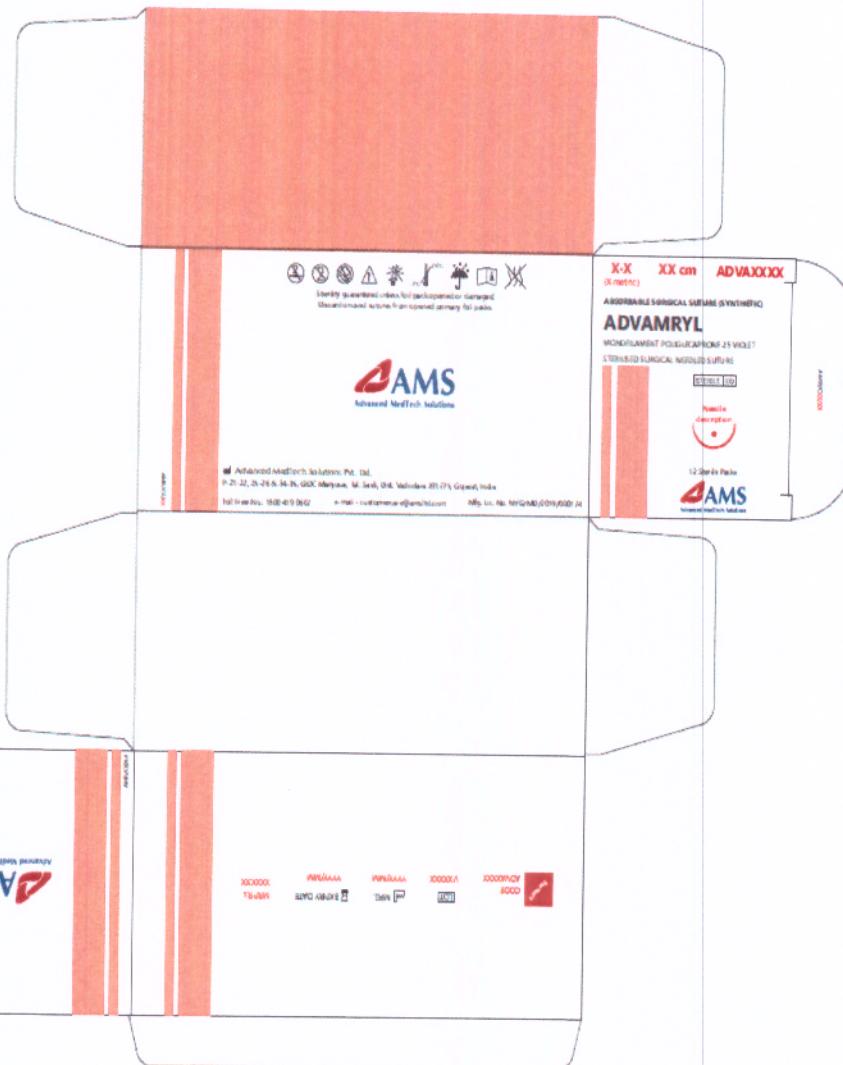


  
Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolino  
Socio Gerente

  
**ALCAMED S.R.L.**  
DIRECTOR TECNICO  
MARIO G. MIKELMAN  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554

**ALCAMED SRL**

Acheba 3076 – CABA, Argentina.

Tel.: +54 11 45715616

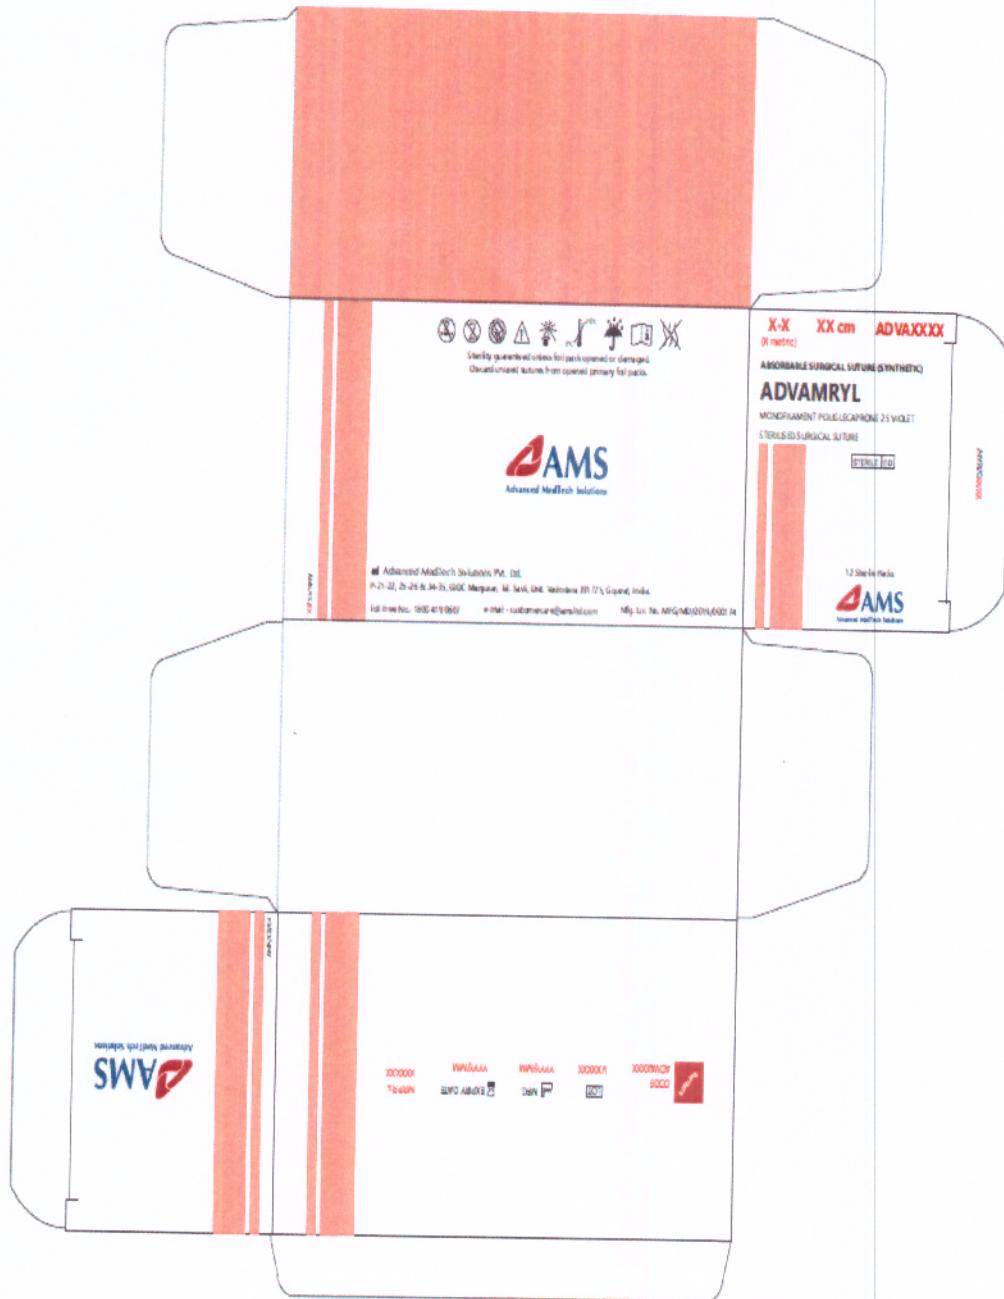[info@alcamedsrl.com.ar](mailto:info@alcamedsrl.com.ar)[alcamedsrl@gmail.com](mailto:alcamedsrl@gmail.com)[www.alcamedsrl.com.ar](http://www.alcamedsrl.com.ar)**ALCAMED S.R.L.**  
INSUMOS MEDICOS

Alcamed S.R.L.  
Alberto Brandolino  
Socio Garante

ALCAMED S.R.L.  
DIRECTOR TECNICO  
MARIO G. MATELMAN  
FARMACÉUTICO - M.P. 8554



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rotulo e instrucciones de uso- ALCAMED S.R.L.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.